


Testrapport

Rapport nummer 1
 Testdatum 20-03-26
 Ref. klant Keuring 20-3
 Ref. Revin Brielle 20260999

	<u>Testinstrument</u>	<u>Instrument</u>	
Instrumentnummer	2276853	1235662	321654987
Fabricaat	Wika	Revin	
Omschrijving	Dig. Testmanometer	Manometer	
Meetbereik	0-160 bar	0-100 bar	
Klasse	0.1	1.0	
Klant	United Rentals		
Getest door	B. Sewkaransing		

Meetpunten	Range	Meetwaarde		Meetfout %	
	Bar	Stijgend	Dalend	Stijgend	Dalend
1	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
2	20,00	19,90	20,20	-0,100	0,200
3	40,00	39,80	40,40	-0,200	0,400
4	60,00	59,70	60,60	-0,300	0,600
5	80,00	79,60	80,80	-0,400	0,800
6	100,00	101,00	101,00	1,000	1,000

Getest volgens DIN en 837-1: 1997

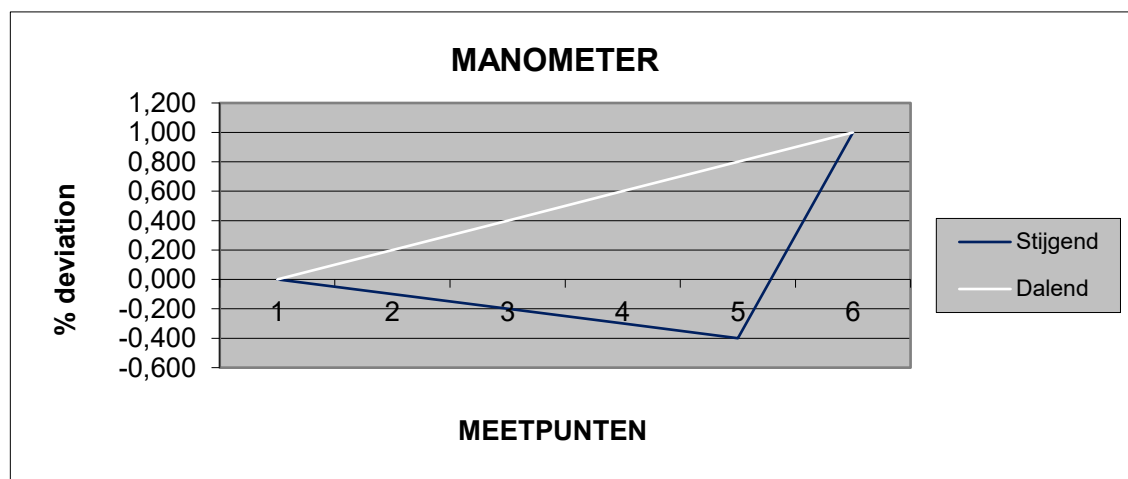

REVIN BRIELLE B.V.
 't Woud 18
 3232 LN Brielle
 Tel: 0181 413094
 email: info@revinbrielle.com